

ZP/2505/21/21

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne****dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów do Zakładu Patomorfologii
- ZP/2505/21/2021**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
odczynniki i materiały zużywalne		
1	poz. 2, 3, 6, 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. asortymentowych nr 2, 3, 6, 7 z pakietu nr 2 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.	Nie dopuszczamy
2	poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie żelu do kriostatu do zamrażania tkanek, żywica utrwalająca tworzy silne połączenie z uchwytem na próbkę, zabezpieczającym tkankę w opakowaniach po 100ml?	Dopuszczamy
3	Poz.1,8,9: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Jest to asortyment odbiegający od ogółu produktów umieszczonych w pakiecie, przez co może ograniczyć udział w postępowaniu wykonawcom specjalizującym się w sprzedaży materiałów do zakładów patomorfologii.	Dopuszczamy
4	Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego medium do zaklejania preparatów mikroskopowych na bazie ksylenu o lepkości 125-200 cps, bezbarwnego, pozwalające wykonać trwałe preparaty mikroskopowe, dzięki czemu nie ulegają one odbarwieniu i mogą być przechowywane przez wiele lat. Współczynnik załamania światła niemal identyczny jak szkła (ok. 1,495), co zapewnia preparatom odpowiednią przejrzystość i kontrast. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu.	Dopuszczamy
5	Poz.11: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie stopnia czystości alkoholu (skażony, czysty, czysty do analizy).	Etylowy alkohol bezwodny czysty do analizy 99,8%.
6	Poz.11: Czy Zamawiający dopuści alkohol całkowicie skażony absolutny, będący mieszkanką alkoholu etylowego (90%), izopropylowego (5,5%) i metylowego (4,5%), dedykowany dla zakładów patomorfologii?	Nie dopuszczamy

7	Poz.11: Czy Zamawiający dopuści alkohol etylowy 99,8%, całkowicie skażony?	Nie dopuszczamy
8	Poz.12: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie eozyiny żółtawej rozpuszczalnej w wodzie w dwóch opakowaniach po 5g.	Dopuszczamy
9	Poz.13: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zestawu do barwienia histochemicznego Mucicarmine w ilości jednego zestawu, a nie 100 ml?	Dopuszczamy Mucicarmine zestaw do barwienia histochemicznego w ilości jeden zestaw.
10	Poz.16: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do barwienia histochemicznego Congo Red przeznaczonego do wykrywania amyloidów.	Dopuszczamy Congo Red

noże

1	<p>poz.1 i 2: Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 x 0,25 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczękę uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji. Tym bardziej, że Zamawiający, używając nazwy handlowej noży mikrotomowych dla obu pozycji, a także nie wskazując możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych, de facto ogranicza konkurencję do dystrybutora tych ostrzy na terenie Polski, tj. firmy OPTA-TECH. W konsekwencji powyższego Zamawiający może otrzymać jedną ofertę, co może przyczynić się do zwiększenia wydatkowania środków publicznych na daną część zamówienia.</p>	<p>Dopuszczamy zmianę opisu przedmiotu zamówienia z: „noże mikrotomowe SLEE LPH/SLEE LPS” na: „noże mikrotomowe typu SLEE”</p>
---	---	---

Nie bez znaczenia jest fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyty, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.

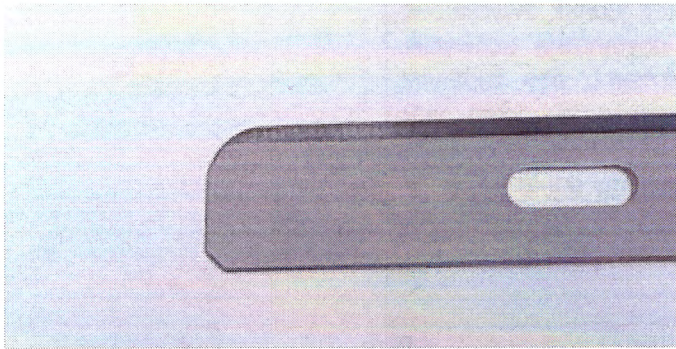


Tym samym wnosimy o:

- odstępnie od wymogu: **„2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyłki dla długości oraz 5mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów)”** dla każdej z pozycji zadania

- zmianę opisu przedmiotu zamówienia z: **„noże mikrotomowe SLEE LPH/SLEE LPS”** na: **„noże mikrotomowe typu SLEE LPH/typu SLEE LPS”**

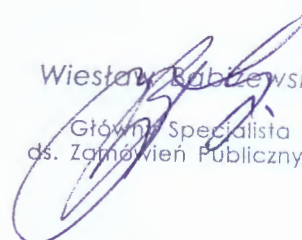
- dopuszczenie rozwiązań równoważnych w postaci zaofiarowania noży niskoprofilowych o wymiarach 80x8x0,25mm, wykonanych ze stali nierdzewnej, o kącie natarcia ostrza 35 stopni, wykonanych w technologii podnoszącej trwałość ostrza;

	<p>przeznaczenie noży do poszczególnych rodzajów tkanek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza noże o narożnikach żyłki ściętych pod kątem 45 stopni (jak na poniższym zdjęciu). Zamawiający nie wskazał precyzyjnie sposobu fazowania krawędzi żyłki, a sposób wskazany na zdjęciu poniżej jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, gdyż lekko zaokrąglone ścięte brzegi jeszcze lepiej wpływają na bezpieczeństwo użytkownika niż prosto ścięte krawędzie i minimalizują ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu.</p> 	
Dotyczy umowy		
1	<p>Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiąganę przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.</p>	Zgodnie z SWZ
2	<p>Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 20% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?</p>	Zgodnie z SWZ
3	<p>Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. <i>„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które</i></p>	Zgodnie z SWZ

	<p><i>odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której odstąpienie dotyczy..”</i></p> <p>Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.</p>	
4	<p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż</p> <p>„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?</p> <p>Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.</p>	Tak wyrażamy zgodę

Zamawiający publikuje **nowy Załącznik nr 2** – zestawienie asortymentowo-wartościowe i wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **19.03.2020r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).


DYREKTOR
 Andrzej Kamasa


 Wiesław Babiczewski
 Główny Specjalista
 ds. Zamówień Publicznych